

# CareMat

## mit austauschbarem Kabel

Die druckempfindliche Bettvorlage für demente und sturzgefährdete Personen

### Originalbetriebsanleitung

## 1 Sicherheitshinweise



- Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie sie zur zukünftigen Verwendung auf.
- Kein Sicherheitsbauteil gemäß EU-Maschinenrichtlinie, darf nicht für Personenschutz oder NOT-AUS-Funktion verwendet werden
- Verwenden Sie dieses Produkt nur für den dafür vorgesehenen Verwendungszweck.
- Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitsvorkehrungen kann Schäden am Gerät oder an anderen Objekten verursachen und zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
- Beachten Sie alle lokalen, nationalen und internationalen Normen, Bestimmungen und Gesetze in Bezug auf Sicherheit.
- Stellen Sie nach dem Zugriff auf den Innenraum des Geräts sicher, dass die Abdeckung/ Schutzdichtung fest verschlossen ist, um die angegebene Schutzart zu erreichen.
- Bei Produkt-, Sach- oder Personenschäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch.

### Hinweise für das Pflegefachpersonal

- Die CareMat dient lediglich zur Unterstützung des Pflegefachpersonals, ersetzt dieses jedoch nicht.
- Vor jedem Einsatz muss die CareMat von einer eingewiesenen Person auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden.

### Hinweise für den Installateur


- Die elektrische Montage und Inbetriebnahme des Produkts darf nur von einer Fachkraft ausgeführt werden.
- Vermeiden Sie generell Berührungen mit elektronischen Bauteilen.
- ESD-Schutz beachten.
- Das Produkt darf nicht an Netzspannung angeschlossen werden (siehe «Elektrische Anschlussvarianten»).

## 2 Produktbeschreibung


### 2.1 Anwendungsbereiche und Funktion

Die CareMat wurde vorwiegend für den Einsatz in Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern und Psychiatrien, sowie für betreutes Wohnen konzipiert. Die dort notwendige Pflege und Beaufsichtigung von dementen und sturzgefährdeten Bewohnern stellt für das Betreuungspersonal einen erhöhten Pflegeaufwand dar. Die CareMat ist die ideale Unterstützung: Sturzrisiken sowie Gefahren, die sich durch Weglaufen oder Orientierungslosigkeit ergeben, können erheblich verringert werden.


Die CareMat wird als druckempfindlicher Sensor direkt vor das Pflege- bzw. Krankenbett gelegt und mit der hausinternen Rufanlage verbunden. Sobald die Person das Bett verlässt und auf die CareMat tritt, schaltet diese und löst einen Alarm über die Rufanlage aus.



**CareMat A01C**  
**CareMat A11C**  
1100 x 700 mm



**CareMat B01C**  
**CareMat B11C**  
700 x 400 mm




**CareMat C01C**  
**CareMat C11C**  
1100 x 700 mm,  
halbrund


- ① Austauschbares Kabel zum Anschluss an die Rufanlage
- ② Offenes Kabelende
- ③ Gehäuse mit Klemmen- oder Universalplatine
- ④ Abgeschrägte, rollstuhlgängige Kanten

- ⑤ Rutschfeste Oberfläche mit Noppenstruktur
- ⑥ Tragegriffe
- ⑦ Schaltaktive Zone


## 3 Täglicher Betrieb



Die CareMat zentriert vor dem Bett positionieren, damit ein Umgehen der Matte unmöglich ist. Das Kabel unter dem Bett hindurchführen, um die Stolpergefahr zu vermeiden. Stecker in die richtige Steckvorrichtung einstecken.



Wird die CareMat nicht benötigt, kann sie unter das Bett geschoben werden, ohne dass die Kabelverbindung zur Rufanlage gelöst werden muss.



Bevor das Bett verschoben wird, CareMat entfernen. Somit werden Beschädigungen an der Matte bzw. am Kabel und Stecker vermieden.

## 4 Reinigung und Desinfektion


- Vor jeder Reinigung die Verbindung zur Rufanlage trennen.
- Die CareMat kann mit handelsüblichen Desinfektions- und Reinigungsmitteln mit max. 70 Vol% Alkohol gereinigt werden. Keine ätzenden Mittel verwenden.
- Die CareMat ist weder autoklavierbar, noch dampfdesinfizierbar.

## 5 Transport und Lagerung

- Beim Transport und Lagerung starkes Durchbiegen der CareMat vermeiden.
- Die CareMat trocken, sauber und flach lagern.
- Keine schweren Lasten auf der CareMat lagern und nicht mehr als 20 verpackte Matten aufeinander stapeln.

## 6 Elektrischer Anschluss mit Klemmenplatine

Die CareMat xx1C (C = Cable) enthält eine Klemmenplatine im Gehäuse.



Der passende Stecker zum Anschluss an die Rufanlage und dessen Anschlussbelegung sind beim jeweiligen Systemhersteller zu beziehen.

## 7 Wartung und Fehlersuche

Die CareMat ist wartungsfrei. Sollte das Kabel dennoch ausgerissen werden, kann es einfach ausgetauscht werden: Gehäusedeckel öffnen, Kabel ersetzen und anschliessen. Der Kabelbinder um das Anschlusskabel muss mit einer Kabelbinderzange angezogen werden, damit er nicht abrutscht. Deckel schliessen und Schrauben leicht anziehen.

Sollte die Funktion trotzdem nicht gewährleistet sein, sind folgende Schritte zu prüfen:

- Ist die Rufanlage in Betrieb und die CareMat korrekt angeschlossen?
- Ist der Stecker, die Steckverbindung oder das Kabel beschädigt?

Sind die erwähnten Punkte erfüllt, aber die Funktionen der CareMat ist trotzdem nicht gewährleistet, wenden Sie sich bitte an das Fachpersonal

## 8 Technische Daten

<b>Artikel</b>	CareMat Ax1C / Bx1C / Cx1C	<b>Kabel</b>	Länge 3 m, Durchmesser 5.2 ± 0.2 mm
<b>Masse (LxBxH)</b>	1100x700x9 mm / 700x400x9 mm / 1100x700x9 mm, Höhe bei Gehäuse 15 mm	<b>Kabeltyp</b>	4-polig, LiYYv 4 x 0.34 mm <sup>2</sup>
<b>Gewicht [kg]</b>	8.2 kg / 3.2 kg / 6.5 kg	<b>Signalausgang</b>	Mechanischer Schliesserkontakt, Transistor Öffnerkontakt, Widerstandsbeschaltung
<b>Material</b>	Polyurethan (PU)	<b>Elektrische Belastbarkeit</b>	max. 25 mA bei 3 – 24 V DC
<b>Farbe</b>	Matte: Careyellow, Caregrey; Kabel: weiss	<b>Schutzart</b>	IP54 ohne Kabelende/Verbindungsstecker
<b>Oberfläche</b>	Noppenstruktur	<b>Umgebungstemperatur</b>	0 bis +55 °C
<b>Personengewicht</b>	mindestens 10 kg		
<b>Chemische Beständigkeit</b>	Wasser (Raumtemp.), Körperflüssigkeiten, handelsübliche Desinfektionsmittel, max. 70 Vol% Alkohol		<i>Technische Änderungen vorbehalten</i>

## 9 EU-Konformitätserklärung

 Siehe Anhang

## 10 WEEE



Geräte mit diesem Symbol müssen bei der Entsorgung gesondert behandelt werden. Dies muss in Übereinstimmung mit den Gesetzen der jeweiligen Länder für umweltgerechte Entsorgung, Aufarbeitung und Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten erfolgen.

## 11 Kontakt

**BBC Bircher Smart Access**, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, [www.bircher.com](http://www.bircher.com)

# CareMat

## with replaceable cable

The pressure-sensitive bed mat for dementia patients and persons at risk of falling

### Translation of the original instructions

## 1 Safety instructions



- Read these operating instructions thoroughly before putting the device into operation and keep them for future reference.
- Not a safety component in accordance with the EU Machinery Directive must not be used for personal protection or EMERGENCY STOP function.
- Do not use this product other than for its specified application.
- Failure to follow these safety precautions may cause damage to device or objects, serious personal injury, or death.
- Observe all applicable local, national, and international safety standards, codes, and laws.
- After accessing the inside of the device, ensure the cover/protection seal is closed tightly to achieve designated protection rating.
- Warranty claims will be invalid in the event of any damage to the product, to goods or persons that is due to failure to observe these instructions.

### Instructions for nursing staff

- The CareMat operates purely as a support for the nursing staff, but is not a substitute for them.
- The functionality of the CareMat is to be checked each time that it is used.

### Notes for the installer


- The electrical installation work and commissioning of the product may only be carried out by a qualified technician.
- Avoid touching any electronic components.
- ESD safety rules should be observed.
- The product must not be connected to mains voltage (see "Different Types of Electrical Connections").

## 2 Product description


### 2.2 Areas of application and function

The CareMat was primarily designed for use in retirement and nursing homes, hospitals and psychiatric wards as well as for sheltered residential accommodation. The necessary care and supervision of patients with dementia and of those who are at risk of falling represents a significant increase in care expenditure for care practitioners. The CareMat is the ideal support: Risks of falling and the dangers which arise from wandering or loss of orientation can be significantly reduced.


The CareMat, as a pressure-sensitive sensor, is installed directly in front of the carepatient's or sick person's bed and is connected to the internal call system. As soon as the person leaves the bed and steps onto the CareMat this switches on and sends out an alarm signal to the call system.

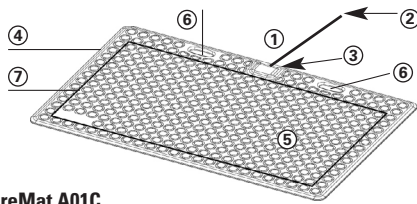

**CareMat A01C**  
**CareMat A11C**  
1100 x 700 mm

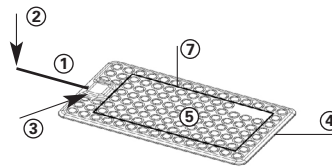

**CareMat B01C**  
**CareMat B11C**  
700 x 400 mm

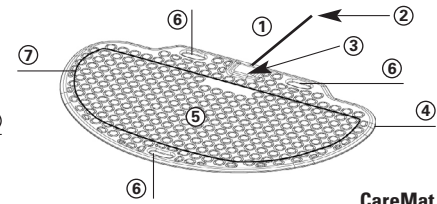


**CareMat C01C**  
**CareMat C11C**  
1100 x 700 mm,  
semi-circular


- ① Replaceable cable for connecting to the call system
- ② Open cable end
- ③ Housing with terminals or universal circuit-board
- ④ Chamfered, wheelchair-accessible edges

- ⑤ Non-slip surface with stud texture design
- ⑥ Carrying handle
- ⑦ Active switching zone


## 3 Day to day operation

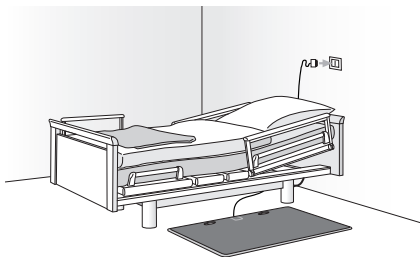

Position the CareMat centrally in front of the bed, that avoiding the mat is impossible. Route the cable under the bed in order to avoid the risk of tripping over it. Insert the plug into the correct plug socket device.

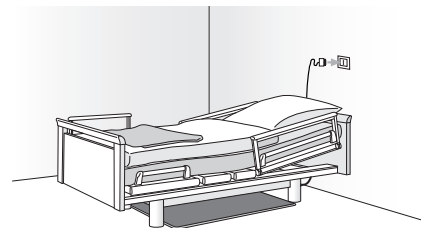

If the CareMat should not be needed, it can be pushed beneath the bed without the cable connection to the call system having to be disconnected.

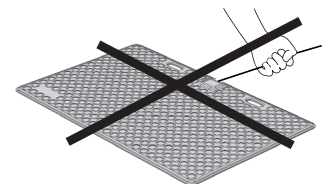

Remove CareMat before moving the bed. This will avoid any unnecessary damage to the mat or connecting cable.

## 4 Cleaning and disinfecting


- Disconnect the connection to the call system prior to any cleaning.
- CareMat can be cleaned using commercially available disinfecting and cleaning agents with max. 70 vol% alcohol. No corrosive agents should be used.
- CareMat is neither autoclavable nor can it be disinfected using steam.

## 5 Transport and storage

- During transport and storage any significant bending of the CareMat should be avoided.
- Store the CareMat in a dry, clean and flat location.
- Do not place any heavy loads on the CareMat and do not stack more than 20 packed mats on top of each other.

## 6 Electrical connections with terminals circuit-board

The CareMat xx1C (C = cable) includes a terminal circuit-board in the housing.



The correct plug for connecting to the alarm system and its terminal assignment are to be obtained from the relative system manufacturer.

## 7 Maintenance and fault finding

The CareMat is maintenance-free. If the cable should however be pulled out. It can simply be replaced: open housing, replace and connect up cable. The cable ties around the connecting cable must be stripped using a cable tie tool to avoid any slipping. Close the cover and lightly tighten the screws.

If despite this, the function is not being provided, the following checks should be made:

- Is the call system operating and is the CareMat correctly connected?
  - Is the plug, the plug connection or the cable damaged?
- If the points mentioned above have been checked out, but the functions of the CareMat are, despite this, still not being provided, you should consult a qualified expert.

## 8 Technical specifications

<b>Article</b>	CareMat Ax1C / Bx1C / Cx1C	<b>Cable</b>	Length 3 m, diameter 5.2 ± 0.2 mm
<b>Dimensions (LxWxH)</b>	1100x700x9 mm / 700x400x9 mm / 1100x700x9 mm, height with housing 15 mm	<b>Type of cable</b>	4 pole, LiYYv 4 x 0.34 mm <sup>2</sup>
<b>Weight [kg]</b>	8.2 kg / 3.2 kg / 6.5 kg	<b>Signal output</b>	Mechanical NO contact, transistor NC contact, resistor wiring
<b>Material</b>	Polyurethane (PU)	<b>Electrical load capacity</b>	max. 25 mA at 3 – 24 V DC
<b>Colour</b>	Mat: Careyellow, Caregrey; Cable: white	<b>Type of protection</b>	IP54 without cable end / connecting plug
<b>Surface</b>	Stud texture design	<b>Ambient temperature</b>	0 up to +55 °C
<b>Weight of persons</b>	At least 10 kg		
<b>Chemical resistance</b>	Water (room temperature), body fluids, disinfectant, max. 70 vol% alcohol	<i>Subject to technical modifications</i>	

## 9 EU Declaration of Conformity

 See attachment

## 10 WEEE



Devices with this symbol must be treated separately during disposal. This must be done in accordance with the laws of the respective countries for environmentally sound disposal, processing and recycling of electrical and electronic equipment.

## 11 Contact

**BBC Bircher Smart Access**, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, [www.bircher.com](http://www.bircher.com)

# CareMat

## avec câble interchangeable

Modèle de tapis sensible à la pression pour les personnes nécessitant une surveillance accrue et sujettes aux chutes

### Traduction de la notice originale

## 1 Instructions de sécurité



- Lire attentivement ces instructions d'utilisation avant de mettre l'appareil en service et les conserver pour pouvoir les consulter ultérieurement.
- Il ne s'agit pas d'un composant de sécurité selon la directive européenne relative aux machines, il ne doit pas être utilisé pour la protection des personnes ou la fonction d'arrêt d'urgence.
- N'utiliser ce produit que conformément à l'utilisation prévue.
- Le non-respect de ces consignes de sécurité peut entraîner des dommages au niveau de l'appareil ou d'autres objets et conduire à des blessures graves, voire mortelles.
- Respecter toutes les normes, dispositions et réglementations locales, nationales et internationales relatives à la sécurité.
- Après avoir accédé à l'intérieur de l'appareil, s'assurer que le couvercle / joint de protection est bien fermé pour atteindre le niveau de protection désigné.
- En cas de dommage aux produits, matériels ou personnes, provoqué par le non-respect de cette directive, la garantie cesse d'être valable.

### Notes pour le personnel infirmier

- Le CareMat sert d'aide au personnel infirmier, il ne le remplace pas.
- Avant toute mise en place, il est nécessaire de vérifier le bon fonctionnement du CareMat.

### Instruction pour l'installateur


- Le montage électrique et la mise en service du produit ne doivent être réalisés que par un professionnel qualifié.
- En règle générale, éviter tout contact avec les composants électroniques.
- Respecter la protection ESD.
- Le produit ne doit pas être connecté à la tension du secteur (voir «Options de connexions électriques»).

## 2 Description du produit

### 2.2 Applications et fonctions


Les CareMat sont conçus principalement pour être installés dans des maisons de retraite, centres de soins, hôpitaux et centres psychiatriques, ainsi que dans des logements médicalisés. Lorsque la garde et la surveillance des résidents atteints de démence et pouvant chuter sont intensifiées, cela représente des exigences de maintenance accrues pour le personnel d'encadrement. Le CareMat est l'aide idéale: Les risques de chute et les dangers qui résultent d'une fugue ou d'une désorientation peuvent être considérablement réduits.

Le CareMat est un capteur sensible à la pression, placé directement en face du lit de repos ou médicalisé, et connecté au centre d'appel interne du bâtiment. Dès que la personne quitte le lit et pose le pied sur le CareMat, celui-ci s'allume et déclenche une alarme au centre d'appel.




**CareMat A01C**  
**CareMat A11C**  
1100 x 700 mm

- ① Câble interchangeable pour le raccordement au centre d'appel
- ② Fin de câble ouverte
- ③ Boîtier avec platine à brides ou universelle
- ④ Bords biseautés pour fauteuil roulant




**CareMat B01C**  
**CareMat B11C**  
700 x 400 mm

- ⑤ La surface antidérapante avec structure à nodules
- ⑥ Poignée
- ⑦ Zone active




**CareMat C01C**  
**CareMat C11C**  
1100 x 700 mm, demi-rond


## 3 Usage quotidien



Centrer le CareMat face au lit, afin de rendre impossible le contournement du tapis. Tirer le câble sous le lit afin de réduire le risque de trébucher. Insérez la prise dans le bon sens.



Lorsque le CareMat n'est pas nécessaire, il peut être glissé sous le lit, sans que le raccordement du câble au centre d'appel ne soit débranché.



Avant de déplacer le lit, retirer le CareMat. Cela empêchera tout dommage au tapis, au câble ou à la prise.

## 4 Nettoyage et désinfection


- Déconnecter du centre d'appel avant tout nettoyage.
- Le CareMat peut être nettoyé avec des désinfectants et des produits de nettoyage avec max. 70% d'alcool disponibles dans le commerce. Ne pas utiliser un agent caustique.
- Le CareMat n'est ni autoclavable ni désinfectable par vapeur.

## 5 Transport et rangement

- Pendant le transport et le rangement, éviter une forte flexion du CareMat.
- Entreposer le CareMat sec, propre et à plat.
- Ne pas poser de charge lourde sur le CareMat et ne pas ranger plus de 20 tapis les uns sur les autres.

## 6 Raccordement électrique – avec platine à bride

Le CareMat xx1C (C = Câble) comprend une platine à bride dans son boîtier.



Le connecteur de raccordement pour le raccordement au centre d'appel et son brochage sont disponibles auprès des fabricants de systèmes respectifs.

## 7 Entretien et dépannage

Le CareMat est sans maintenance. Si le câble est endommagé, il est facile de le remplacer: Ouvrir le couvercle, remplacer le câble et connecter. Le serre-câble autour du câble doit être serré avec une pince à câble, afin qu'il ne glisse pas. Refermer le couvercle et serrer les vis sans forcer.

Si le fonctionnement ne peut toujours pas être assuré, les étapes suivantes sont à examiner:

- Le centre d'appel est-il en service et le CareMat correctement raccordé?
- La prise, le connecteur ou le câble sont-ils endommagés?

Si tous les points nécessaires sont remplis, mais que le fonctionnement du CareMat n'est cependant toujours pas assuré, faire appel à un professionnel qualifié.

## 8 Données techniques

<b>Article</b>	CareMat Ax1C / Bx1C / Cx1C	<b>Câble</b>	Longueur 3 m, diamètre $5.2 \pm 0.2 \text{ mm}^2$
<b>Dimensions (LxIxH)</b>	1100x700x9 mm / 700x400x9 mm / 1100x700x9 mm, hauteur au niveau du boîtier 15 mm	<b>Type de câble</b>	4 broches, LiYYv 4 x 0.34 mm <sup>2</sup>
<b>Poids [kg]</b>	8.2 kg / 3.2 kg / 6.5 kg	<b>Sortie du signal</b>	Contact de type sortie relais, contact NC (NF) à transistors, par circuit de résistance
<b>Matériau</b>	Polyuréthane (PU)	<b>Charge électrique admissible</b>	25 mA max. de 3 – 24 V cc
<b>Couleur</b>	Tapis: Careyellow, Caregrey; câble: blanc	<b>Type de protection</b>	IP54 sans fin de câble / connecteur
<b>Surface</b>	Structure en relief antidérapante	<b>Température ambiante</b>	0 jusqu'à +55 °C
<b>Poids de la personne</b>	Minimum 10 kg		
<b>Résistance chimique</b>	Eau (temp. ambiante), fluides corporels, désinfectants usuels, max. 70 Vol% Alcool		<i>Sous réserve de modifications techniques</i>

## 9 Déclaration de conformité de l'UE

 Voir annexe

## 10 WEEE



Lors de leur élimination, les appareils portant ce symbole doivent être traités comme déchets spéciaux, ceci devant s'effectuer conformément à la législation des pays respectifs relative à l'élimination, le retraitement et le recyclage écologiquement rationnels des appareils électriques et électroniques.

## 11 Contact

**BBC Bircher Smart Access**, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, [www.bircher.com](http://www.bircher.com)

# CareMat

## con cable intercambiable

La alfombrilla sensible a la presión para personas con demencia o riesgo de caída

### Traducción del manual de instrucción original

## 1 Indicaciones de seguridad

- Las presentes instrucciones de servicio deberán leerse detenidamente antes de poner en funcionamiento el dispositivo y conservarse para futuras consultas.
- No es un componente de seguridad según la Directiva de máquinas de la UE, no debe utilizarse para la protección personal ni para la función de DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA.
- No utilizar este producto para otra aplicación diferente a la especificada.
- La inobservancia de estas medidas de seguridad puede dañar el aparato u otros objetos y causar lesiones graves o incluso la muerte.
- Respete todas las normas, disposiciones y leyes locales, nacionales e internacionales relativas a la seguridad.
- Después de acceder al interior del dispositivo, asegurarse de que la tapa/el sello de protección esté bien cerrado para garantizar la categoría de protección designada.
- Los daños en el producto, materiales o personales que sean resultado del incumplimiento de estas instrucciones excluyen las reclamaciones de garantía.



### Indicaciones para el personal sanitario/cuidador

- La CareMat solo sirve como respaldo para el personal sanitario o cuidador, pero no lo sustituye.
- Siempre antes de usar la CareMat, hay que comprobar su funcionamiento.

### Indicaciones para el instalador


- El montaje eléctrico y la puesta en servicio del producto solo puede realizarlos un técnico especializado.
- Evite en general el contacto con componentes electrónicos.
- Respete la protección ESD.
- El producto no se puede conectar con tensión de red (véase «Opciones de conexión eléctricas»).

## 2 Descripción del producto


### 2.2 Campos de aplicación y funciones

La CareMat fue diseñada, fundamentalmente, para su uso en residencias de ancianos, sanatorios, hospitales, hospitales psiquiátricos y domicilios de residencia asistida. Las tareas de cuidado y vigilancia de residentes con demencias y riesgos de caída suponen un gran esfuerzo para el personal cuidador. La CareMat es la ayuda perfecta: Reduce considerablemente los riesgos de daños por caídas y los peligros que se presentan cuando un paciente pierde la orientación o se escapa.


La CareMat es un sensor sensible a la presión que se coloca directamente delante de la camilla o cama y que se conecta con el sistema de aviso de las instalaciones. En cuanto el paciente abandona la cama y pisa sobre la CareMat, esta se activa y emite una alarma a través del sistema de aviso.



**CareMat A01C**  
**CareMat A11C**  
1100 x 700 mm



**CareMat B01C**  
**CareMat B11C**  
700 x 400 mm




**CareMat C01C**  
**CareMat C11C**  
1100 x 700 mm, semicircular


- ① Cable intercambiable para establecer conexión con el sistema de aviso
- ② Extremo del cable abierto
- ③ Carcasa con placa de bornes o universal
- ④ Bordes inclinados y adecuados para el uso de sillas de ruedas

- ⑤ Superficie antideslizante con "botones"
- ⑥ Asas de transporte
- ⑦ Zona activa


## 3 Servicio diario



Ponga la CareMat centrada, delante de la cama, para que no sea posible bajar de la cama sin pisarla. Pase el cable por debajo de la cama, para evitar tropiezos. Enchufe el conector en la toma adecuada.



Si no es necesario usar la CareMat, basta con deslizarla debajo de la cama. No hace falta soltar la conexión del cable con el sistema de aviso.



Antes de mover la cama, retire la CareMat. De esta forma evitará daños en la alfombrilla, en el cable y en el conector.

## 4 Limpieza y desinfección



- Antes de limpiar la alfombrilla, hay que desconectarla del sistema de aviso.
- La CareMat se puede limpiar con desinfectantes y limpiadores estándar comerciales con un 70 vol% máx. de alcohol. No utilice productos cáusticos.
- La CareMat no se puede esterilizar por autoclave ni se puede desinfectar por vapor.

## 5 Transporte y almacenamiento

- Al transportar y almacenamiento la CareMat evite doblarla en exceso.
- Almacene la CareMat en un lugar seco, limpio y plano.
- No deposite cargas pesadas sobre la CareMat y no apile más de 20 alfombrillas empaquetadas.

## 6 Conexión eléctrica con placa de bornes

La CareMat xx1C (C = Cable) incluye una placa de bornes en la carcasa.



Puede consultar cuál es el conector adecuado para establecer conexión con el sistema de aviso y su asignación en la documentación del fabricante del sistema.

## 7 Mantenimiento y localización de errores

La CareMat no requiere mantenimiento. No obstante, si se rasgara el cable, se puede sustituir fácilmente: Abra la tapa de la carcasa, sustituya el cable y conéctelo. La brida que rodea el cable de conexión debe apretarse con unas tenacillas para que no se suelte. Cierre la tapa y apriete los tornillos suavemente, ¡sin apretar demasiado.

Si a pesar de ello no funcionara correctamente, compruebe lo siguiente:

- ¿El sistema de aviso está en funcionamiento y la CareMat está conectada correctamente?
- ¿El enchufe, la conexión enchufable o el cable están dañados?

Si ha comprobado todos los puntos anteriores pero la CareMat sigue sin funcionar correctamente, consulte con un técnico especializado.

## 8 Datos técnicos

<b>Artículo</b>	CareMat Ax1C / Bx1C / Cx1C	<b>Cable</b>	Longitud 3 m, diámetro 5.2 ± 0.2 mm
<b>Medidas (LxAxAI)</b>	1100x700x9 mm / 700x400x9 mm / 1100x700x9 mm, altura con carcasa 15 mm	<b>Tipo de cable</b>	4 conductores, LiYYv 4 x 0.34 mm <sup>2</sup>
<b>Peso [kg]</b>	8.2 kg / 3.2 kg / 6.5 kg	<b>Salida de señal</b>	Contacto de cierre mecánico, contacto de apertura del transistor, circuito de resistencia
<b>Material</b>	Poliuretano (PU)	<b>Capacidad de carga eléctrica</b>	máx. 25 mA con 3 – 24 V CC
<b>Color</b>	Alfombrilla: Careyellow, Caregrey; cable: blanco	<b>Tipo de protección</b>	IP54 sin extremo de cables/conector
<b>Superficie</b>	Superficie con "botones"	<b>Temperatura ambiente</b>	De 0 hasta +55 °C
<b>Peso personal</b>	mín. 10 kg		
<b>Estabilidad química</b>	Agua (temp. ambiente), fluidos corporales estándar comercial. Desinfectante, 70 vol% máx. alcohol		<i>Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas</i>

## 9 Declaración de conformidad UE

 Ver adjunto

## 10 WEEE



Los aparatos con este símbolo deben tratarse de manera especial al ser eliminados. Dicha eliminación debe efectuarse de conformidad con las leyes de los correspondientes países para la eliminación respetuosa con el medio ambiente, el reacondicionamiento y el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

## 11 Contacto

**BBC Bircher Smart Access**, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, [www.bircher.com](http://www.bircher.com)

# CareMat

## con cavo intercambiabile

Lo scendiletto sensibile alla pressione per persone affette da demenza e con problemi di deambulazione

### Traduzione delle istruzioni originali

## 1 Consulenza sulla sicurezza



- Leggere accuratamente le presenti istruzioni per l'uso prima di mettere in servizio il dispositivo e conservarle per riferimento futuro.
- Non è un componente di sicurezza secondo la Direttiva Macchine UE, non deve essere utilizzato per la protezione personale o per la funzione di ARRESTO DI EMERGENZA.
- Non utilizzare questo prodotto per applicazioni diverse da quella specificata.
- La mancata osservanza di queste precauzioni di sicurezza può causare danni al dispositivo o ad altri oggetti e lesioni gravi, anche mortali.
- Osservare tutte le norme, le disposizioni e le leggi locali, nazionali e internazionali in materia di sicurezza.
- Dopo interventi all'interno del dispositivo, assicurarsi che il coperchio/sigillo di protezione sia ben chiuso per garantire il grado di protezione designato.
- Danni al prodotto, ai materiali o alle persone, causati dalla mancata osservanza delle istruzioni, possono invalidare la garanzia.

### Note per il personale sanitario

- Il CareMat serve solo ad aiutare il personale sanitario, ma non lo sostituisce in nessun modo.
- Prima di ogni utilizzo occorre verificare la funzionalità del CareMat.

### Note per l'installatore


- L'installazione elettrica e la messa in servizio del prodotto possono essere effettuate soltanto da un esperto.
- Evitare in generale di venire a contatto con i componenti elettronici.
- Osservare la protezione ESD.
- Il prodotto non deve essere collegato alla tensione di rete (vedi «opzioni di collegamento elettrico»).

## 2 Descrizione del prodotto


### 2.2 Applicazioni e funzione

Il CareMat è stato creato soprattutto per un impiego in case di cura, case per anziani, ospedali, cliniche psichiatriche e alloggi sorvegliati. Le cure e la sorveglianza di persone affette da demenza e con problemi di deambulazione, richiedono un notevole sforzo al personale curante. Il CareMat offre la necessaria assistenza: minimizza considerevolmente il rischio di cadute così come il pericolo che qualcuno abbandoni la struttura o si perda.


Il CareMat è un sensore sensibile alla pressione, che viene posto direttamente davanti al letto del paziente ed è collegato all'impianto di chiamata interno. Quando la persona si alza dal letto e calpesta il CareMat, viene azionato un allarme tramite l'impianto di chiamata.



**CareMat A01C**  
**CareMat A11C**  
1100 x 700 mm



**CareMat B01C**  
**CareMat B11C**  
700 x 400 mm




**CareMat C01C**  
**CareMat C11C**  
1100 x 700 mm,  
semicircolare


- ① Cavo intercambiabile del collegamento all'impianto di chiamata
- ② Estremità del cavo aperta
- ③ Confezione con morsettiera o scheda universale
- ④ Bordi smussati ed arrotondati

- ⑤ Superficie antiscivolo con struttura a bolle
- ⑥ Maniglie
- ⑦ Zona di attivazione


## 3 Funzionamento giornaliero



Il CareMat viene posto in posizione centrale davanti al letto, per impedire lo spostamento del tappeto. Posizionare il cavo sotto il letto, per evitare il rischio di inciampare. Inserire il connettore nella corretta presa di corrente.



Se il CareMat non è necessario, esso può essere posto sotto il letto, senza dover rimuovere il collegamento del cavo all'impianto di chiamata.



Prima di spostare il letto, rimuovere il CareMat. In tal modo si possono evitare danni al tappeto, al cavo o alla spina.

## 4 Pulizia e disinfezione


- Prima di ogni pulizia, rimuovere il collegamento all'impianto di chiamata.
- Il CareMat può essere pulito con disinfettanti disponibili in commercio e con prodotti per la pulizia con max. 70% volume di alcol. Non utilizzare detergenti caustici.
- Il CareMat non è autoclavabile, né sterilizzabile a vapore.

## 5 Trasporto e conservazione

- Durante il trasporto e la conservazione evitare forti flessioni del CareMat.
- Conservare il CareMat in un luogo asciutto, pulito e piatto.
- Non posizionare carichi pesanti sul CareMat e non impilare più di 20 tappeti confezionati uno sopra l'altro.

## 6 Collegamento elettrico con morsettieria

Il CareMat xx1C (C = Cable) contiene una morsettieria nella confezione.



Il connettore adatto al collegamento all'impianto di chiamata e la sua connessione sono disponibili presso i rispettivi produttori di sistemi.

## 7 Manutenzione e risoluzione dei problemi

Il CareMat non necessita manutenzione. Se il cavo dovesse rovinarsi può essere facilmente sostituito: aprire il coperchio della confezione, sostituire il cavo e collegarlo. La fascetta attorno al cavo di connessione deve essere serrata con una pistola per fascette, in modo che non scivoli. Chiudere il coperchio e serrare leggermente le viti!

Se il dispositivo non funziona, occorre esaminare le seguenti operazioni:

- l'impianto di chiamata in uso ed il CareMat sono collegati correttamente?
- La spina, il connettore elettrico o il cavo sono danneggiati?

Se i punti menzionati funzionano correttamente, ma le funzionalità del CareMat non si avviano, rivolgersi ad un esperto.

## 8 Specifiche tecniche

<b>Articolo</b>	CareMat Ax1C / Bx1C / Cx1C	<b>Cavo</b>	Lunghezza 3 m, diametro 5.2 ± 0.2 mm
<b>Dimensioni (LxPxH)</b>	1100x700x9 mm / 700x400x9 mm / 1100x700x9 mm, altezza con confezione 15 mm	<b>Tipo di cavo</b>	4 poli, LiYYv 4 x 0.34 mm <sup>2</sup>
<b>Peso [kg]</b>	8.2 kg / 3.2 kg / 6.5 kg	<b>Uscita di segnale</b>	Contatto di chiusura meccanico, contatto di apertura a transistor, circuito di resistenza
<b>Materiale</b>	Poliuretano (PU)	<b>Portata elettrica</b>	max. 25 mA a 3 – 24 V DC
<b>Colore</b>	Tappeto: Careyellow, Caregrey; cavo: bianco	<b>Tipo di protezione</b>	IP54 senza estremità del cavo / connettore
<b>Superficie</b>	Struttura a bolle	<b>Temperatura ambientale</b>	0 fino a +55 °C
<b>Peso persona</b>	Minimo 10 kg		
<b>Resistenza chimica</b>	Acqua (temperatura ambiente), liquidi corporei, disinfettante disponibile in commercio, max. 70% volume di alcol.	<i>Con riserva di modifiche tecniche</i>	

## 9 Dichiarazione di conformità UE

 Vedere allegato

## 10 RAEE-WEEE



Gli apparecchi recanti questo simbolo devono essere smaltiti separatamente, in conformità alle leggi previste dai rispettivi paesi per lo smaltimento, il recupero e il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel rispetto dell'ambiente.

## 11 Contatto

BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, [www.bircher.com](http://www.bircher.com)

# CareMat

## med utbytbar kabel

Den tryckkänsliga mattan för dementa patienter och personer med benägenhet att falla

### Översättning av originalbruksanvisning

## 1 Säkerhetsanvisningar



- Läs denna skötselanvisning noggrant innan du tar enheten i drift och behåll den för senare bruk.
- Ingen säkerhetskomponent enligt EU maskindirektiv, får inte användas för personskydd eller NÖDSTOPP-funktionen.
- Använd inte denna produkt på annat sätt än för den specifika applikationen.
- Om dessa säkerhetsåtgärder inte iakttas kan det leda till skador på enheten eller andra föremål samt svåra skador eller dödsfall.
- Lakta alla lokala, nationella och internationella normer, bestämmelser och lagar gällande säkerhet.
- Väl inuti enheten måste man se till att skyddet/skyddstättningen sluter tätt för att uppnå det angivna skyddet.
- Vid produkt-, material- eller personskador som orsakas av att denna bruksanvisning inte följs, upphör garantin att gälla.

### Anvisningar för vårdpersonalen

- CareMat ger endast stöd för vårdpersonalen men ersätter dem inte.
- Före varje användning ska CareMat kontrolleras avseende korrekt funktion.

### Anvisningar för installatören


- Produktens elektriska montering och idrifttagning får endast utföras av en fackman.
- Undvik alltid att vidröra elektroniska komponenter.
- Observera ESD-skyddet.
- Produkten får inte anslutas till nätspänning (se «Elektriska anslutningsvarianter»).

## 2 Produktbeskrivning


### 2.2 Användningsområden och funktion

CareMat är i första hand utformad för användning i äldreboende och vårdhem, sjukhus och psykiatriska avdelningar samt på särskilt boende. Vården för och tillsynen av personer som har demens eller som är benägna att falla kräver här ökade ansträngningar och insatser från vårdpersonalen. CareMat är det perfekta hjälpmedlet: risken för fall, liksom faran för att patienter försvinner och går vilse kan minskas avsevärt.


Som tryckkänslig sensor läggs CareMat direkt framför patientens säng och kopplas till det interna patientsignalsystemet. När patienten lämnar sängen och kliver på CareMat aktiveras mattan och utlöser ett larm via signalsystemet.



**CareMat A01C**  
**CareMat A11C**  
1100 x 700 mm



**CareMat B01C**  
**CareMat B11C**  
700 x 400 mm




**CareMat C01C**  
**CareMat C11C**  
1100 x 700 mm,  
halvrund


- ① Utbytbar kabel för anslutning till patientsignalsystemet
- ② Öppen kabelände
- ③ Hus med plintkort eller universellt kretskort
- ④ Sluttande kanter, lämpliga för rullstolar

- ⑤ Halkfri yta med halkfri struktur
- ⑥ Bärhandtag
- ⑦ Aktiv kontaktzon


## 3 Daglig drift



Placera CareMat i mitten framför sängen så att patienten inte kan gå runt mattan. Lägga kabeln under sängen för att undvika snubbelrisk. Sätt in kontakten i rätt uttag.



Om CareMat inte behövs kan den skjutas under sängen utan att kabelkopplingen till patientsignalsystemet behöver kopplas från.



Ta bort CareMat innan sängen förflyttas. På det sättet undviker man skador på mattan eller kabeln samt kontakten.

## 4 Rengöring och desinfektion


- Koppla från kopplingen till patientsignalsystemet före varje rengöring.
- CareMat kan rengöras med vanliga desinfektions- och rengöringsmedel som innehåller max. 70 vol% alkohol. Använd inga frätande medel.
- CareMat kan inte autoklaveras eller desinficeras med ånga.

## 5 Transport och lagring

- Undvik överdriven böjning av mattan
- Förvara CareMat utrullad på en plan yta i en torr.
- Placera inte tunga föremål ovanpå mattan och stapla högst 20 inpackade mattor ovanpå varandra.

## 6 Elektrisk anslutning med plintkort

Vid CareMat xx1C (C = Cable) finns ett plintkort inbyggt i huset.



Den tillhörande kontakten för anslutning till patientsignalsystemet och dess anslutningskodning finns tillgängliga hos respektive systemtillverkare.

## 7 Underhåll och felsökning

CareMat är underhållsfri. Om kabeln ändå rivs ut kan den enkelt bytas ut: Öppna husets lock, ersätt kabeln och anslut den. Buntbandet och anslutningskabeln måste dras åt med en buntbandstång. Stäng locket och dra åt skruvarna lätt.

Om det ändå inte skulle fungera bör följande steg kontrolleras:

- Är signalsystemet och CareMat korrekt anslutna?
  - Är kontakten, stickkopplingen eller kabeln skadade?
- Om de beskrivna punkterna är uppfyllda, men CareMat ändå inte fungerar, kontakta fackpersonalen.

## 8 Tekniska data

<b>Artikel</b>	CareMat Ax1C / Bx1C / Cx1C	<b>Kabel</b>	Längd 3 m, diameter 5.2 ± 0.2 mm
<b>Mått (LxBxH)</b>	1100x700x9 mm / 700x400x9 mm / 1100x700x9 mm, höjd med hus 15 mm	<b>Kabeltyp</b>	4 pin, LiYYv 4 x 0.34 mm <sup>2</sup>
<b>Vikt [kg]</b>	8.2 kg / 3.2 kg / 6.5 kg	<b>Signalutgång</b>	Mekanisk slutande kontakt, transistor öppnande kontakt, motståndskoppling
<b>Material</b>	Polyuretan (PU)	<b>Elektrisk kapacitet</b>	max. 25 mA vid 3–24 V DC
<b>Färg</b>	Matta: Careyellow, Caregrey; kabel: vit	<b>Kapslingsklass</b>	IP54 utan kabelände / kopplingskontakt
<b>Yta</b>	Halkfri struktur	<b>Omgivningstemperatur</b>	0 till +55 °C
<b>Personvikt</b>	minst 10 kg		
<b>Kemisk beständighet</b>	Vatten (rumstemp.), kroppsvätskor, vanl. desinfektionsmedel, max. 70 vol% alkohol		<i>Tekniska ändringar förbehålls</i>

## 9 EU försäkran om överensstämmelse



Se bilaga

## 10 WEEE



Apparater med denna symbol måste hanteras separat vid återvinningen. Detta ska göras i enlighet med respektive nationella lagar om miljövänlig avfallssortering, bearbetning och återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

## 11 Kontakt

BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, [www.bircher.com](http://www.bircher.com)